

ОСОБЕННОСТИ ИНГАЛЯЦИЙ ЧЕРЕЗ МЕМБРАННЫЙ НЕБУЛАЙЗЕР С НАКОПИТЕЛЕМ/СПЕЙСЕРОМ

После заполнения резервуара для медикамента и включения прибора, следует сразу приступить к ингаляции, не дожидаясь выхода аэрозоля из мундштука
Аэрозоль уже поступает в накопитель

Необходимо вдыхать медленно и глубоко через мундштук
При медленном вдохе больше медикамента попадает в бронхи

Не нужно делать вдохи через нос
Аэрозоль может оседать на стенках накопителя, эффективность лечения снижается

Прибор можно выключить, если нужно сделать перерыв в ингаляции для откашливания или физиотерапии

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ТЕХНОЛОГИЯ ВИБРИРУЮЩЕЙ МЕМБРАНЫ TOUCH SPRAY®

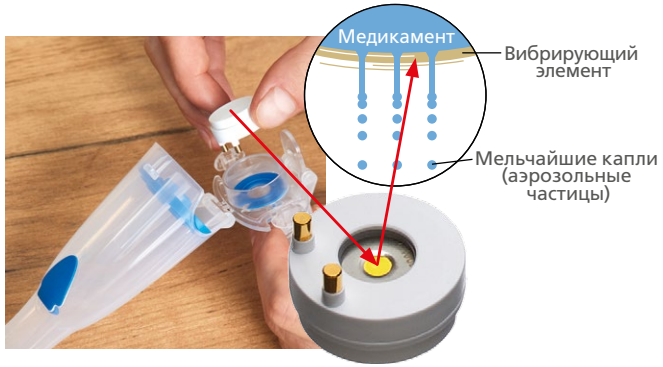

Аэрозоль создается в результате вибрации перфорированной мембраны и прохождения через неё медикамента (без нагревания раствора).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ АЭРОЗОЛЯ

Аэрозоль от генератора поступает в накопитель (спейсер) **(1)**, в результате – потери в окружающую среду минимальны. Система клапанов **(2)** способствует максимальной доставке аэрозоля пациенту.

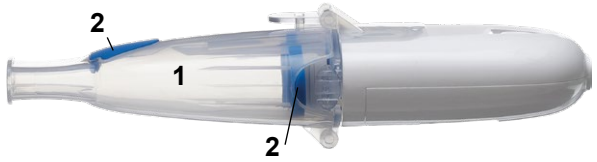

Мы всегда признательны за обратную связь. Просто позвоните нам или отправьте электронное письмо по адресу **office@synmed.ru, sales@synmed.ru**

Посетите наш сайт для получения дополнительной информации:
www.synmed.ru

ООО « СинерМед»
117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.49, а/я 15
тел.: +7 (495) 718-75-91
E-mail: sales@synmed.ru
www.synmed.ru

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СИНЕР МЕД

СОЗДАВАЯ НОВОЕ,
СЛЕДУЕМ ТРАДИЦИЯМ



МЕМБРАННЫЙ
НЕБУЛАЙЗЕР

*pro*MEDANZ®

ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ ИНГАЛЯЦИИ

Регистрационный номер медицинского изделия РЗН 2025/25507 от 30.05.2025 г.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НЕБУЛАЙЗЕР МЕМБРАННЫЙ
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

*pro*MEDANZ®

для лечения дыхательных путей

для детей от 6 лет и взрослых

Небулайзер мембранный **proMEDANZ®** создает оптимальный спектр аэрозольных частиц для глубокого проникновения в легкие.

Накопительная камера\спейсер и система клапанов позволяют уменьшить потери аэрозоля.

Компактность, мобильность и бесшумная работа устройства способствуют комфортному лечению как в домашних условиях, так и в стационарах.

	Размер частиц (MMAD), мкм	Доля частиц менее 5 мкм (%)	Выход аэрозоля мл/мин
Небулайзер мембранный *pro*MEDANZ®	3,20	78	0,3 – 0,7*

** Распыление 4,0 мл 0,09% раствора NaCl (клапан вдоха распылителя активирован) в течение 5 минут. Оценка скорости распыления по формуле: V1-V2/t=S V1 - исходный объем раствора(мл); V2 - нераспыленный объем раствора (мл); t - время распыления (5 минут); S - скорость распыления мл/мин*

Комплект поставки
– Блок управления с батареей автономного питания (1 шт.)
– Модуль аэрозольный (с резервуаром для медикамента и накопителем аэрозоля с клапанами вдоха и выдоха) (1 шт.)
– Головка аэрозольная с мембраной (2 шт.)
– Кабель USB Type-C (1 шт.)
– Руководство по эксплуатации (1 шт.)

Технические данные
Размеры (ДхШхВ)..... 185,5 x 60,1 x 44 мм
Масса .....74 г
Длина кабеля ..... 102,5 см
Частота УЗ колебаний..... 130 кГц
Максимальный объём медикамента..... 4 мл
Минимальный объём медикамента..... 1 мл
Артикул 84755-1

КОМПЛЕКТ СМЕННЫЙ ДЛЯ НЕБУЛАЙЗЕРА МЕМБРАННОГО *pro*MEDANZ®



Аэрозольный модуль-накопитель с системой клапанов, головка аэрозольная с мембраной

арт. 84755-4

Модуль аэрозольный (сменный комплект) подлежит замене через 12 месяцев после начала использования.

ТУ 32.50.21-004-50597925-2024
Регистрационный номер медицинского изделия РЗН 2025/25507 от 30.05.2025 г.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КАК ПРОВОДИТЬ ИНГАЛЯЦИЮ С МЕМБРАННЫМ НЕБУЛАЙЗЕРОМ?

Краткое руководство

Для более подробной информации ознакомьтесь с инструкцией по применению.

1. Помойте руки.



2. Соберите аэрозольный модуль, установив аэрозольную головку с мембраной и клапан вдоха в согласно иснтрукции и защёлкните крепление аэрозольного модуля.





3. Добавьте лекарство в резервуар аэрозольного модуля (не менее 1 мл, не более 4 мл раствора).



4. Совместите аэрозольный модуль с блоком управления. Чтобы лекарство не вылилось, держите прибор горизонтально.



5. Нажмите кнопку включения, чтобы начать распыление.
Во время ингаляции расслабьтесь, не вдыхайте слишком быстро, вдох и выдох делайте через мундштук. Держите устройство горизонтально как показано ниже.



РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Краткое руководство

Для более подробной информации прочитайте и следуйте инструкции по применению.

1. Отсоедините модуль аэрозольный от блока управления, откройте крышку резервуара для медикамента и удалите остаток медикамента.



2. Извлеките клапан вдоха и головку аэрозольную из аэрозольного модуля.



3. Погрузите компоненты аэрозольного модуля в ёмкость с теплой питьевой водой, добавив моющее средство.

4. Оставьте компоненты в мыльном растворе на 3-5 минут, затем извлеките и тщательно промойте в очищенной воде.



5. Проведите дезинфекцию деталей модуля аэрозольного (кроме мембраны) путем кипячения в питьевой воде в течение 5±1 минут.



6. Высушите все компоненты распылителя при комнатной температуре, разместив их на сухой ткани без ворсинок.

7. Храните небулайзер в собранном виде в сухом месте без доступа пыли и прямых солнечных лучей.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.